
CBS™ Filling Tip

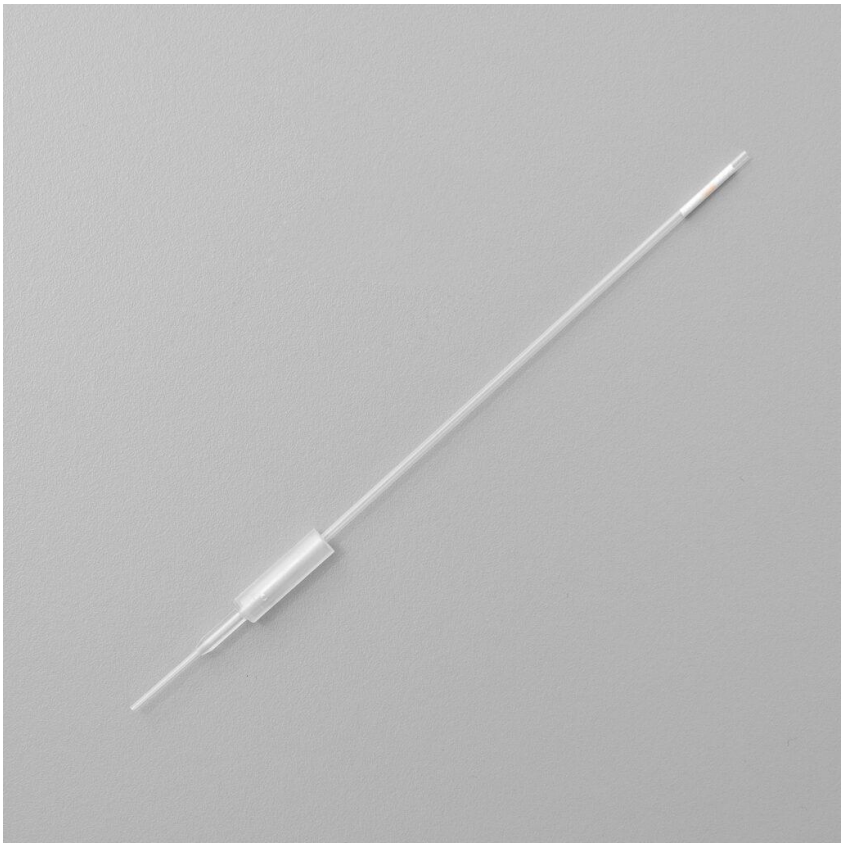

INDICAÇÃO DE USO

A ponteira de preenchimento CBS™ Filling Tip foi desenvolvida para os procedimentos de preenchimento manual das palhetas CBS™ High Security. Seu desenho foi concebido para manter a área de selagem isolada do contato com o líquido durante a ascensão da amostra biológica, contribuindo para a obtenção de uma selagem hermética.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A ponteira de preenchimento CBS é composta por um corpo transparente sobremoldado sobre um capilar transparente. Ela é conectada à extremidade da palheta CBS High Security oposta à tampa de segurança. A conexão firme com a palheta ajuda a isolar a área de selagem do contato com o líquido durante a ascensão da amostra biológica.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Corpo transparente sobremoldado sobre capilar transparente.
- Projetada para estabelecer uma conexão firme com a extremidade da palheta CBS High Security oposta à tampa.

- Isola a área de selagem do contato com o líquido durante a ascensão da amostra.
- Contribui para a obtenção de uma selagem hermética quando utilizada conforme as instruções do fabricante.
- Estéril, de uso único e embalada individualmente em blister destacável.
- Fornecida em caixa com 100 unidades.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Referência principal: 029308.
- Nome comercial: ponteira de preenchimento estéril para palhetas CBS High Security.
- Material e estrutura: corpo transparente sobremoldado sobre capilar transparente.
- Esterilidade: estéril; o certificado de conformidade do fabricante informa esterilização por irradiação.
- Uso: único.
- Embalagem: ponteiras embaladas individualmente em blisters destacáveis; caixa com 100 unidades.

REFERÊNCIAS E APRESENTAÇÕES

- 029308 – Ponteira de preenchimento estéril para palhetas CBS High Security – quantidade: 100 unidades.
- 016731 – Ponteira de conexão para seringa, não estéril, fornecida em embalagens de 5 unidades.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS RELACIONADOS

- Palheta CBS High Security compatível.
- Microaspirador ou seringa para aspiração da amostra biológica.
- Para utilização com seringa: conexão específica 016731.
- Seladora térmica compatível, conforme as instruções de uso das palhetas CBS High Security.

PROCEDIMENTO GERAL DE UTILIZAÇÃO

1. Selecionar uma ponteira estéril CBS 029308 e verificar a integridade da embalagem individual antes do uso.

2. Conectar a ponteira à extremidade da palheta CBS High Security oposta à tampa, garantindo uma conexão firme.

3. Na extremidade da palheta correspondente à tampa, conectar o microaspirador ou uma seringa equipada com a conexão específica 016731.

4. Realizar o preenchimento/aspiração da amostra conforme o procedimento validado pelo laboratório.

5. Após o preenchimento, seguir as instruções de uso da palheta CBS High Security para a selagem. A ponteira foi projetada para manter a área de selagem isolada do contato com o líquido durante a ascensão da amostra.

AVISOS E PRECAUÇÕES

- Dispositivo estéril e de uso único; não reutilizar.
- Não utilizar se a embalagem individual estiver aberta ou danificada.
- Manter técnica asséptica durante o manuseio para reduzir o risco de contaminação da amostra.
- A ponteira deve ser utilizada com palhetas CBS High Security e acessórios de aspiração compatíveis.

ARMAZENAMENTO E DESCARTE

Após o uso, descartar de acordo com as normas locais aplicáveis a resíduos de laboratório potencialmente contaminados.

CONTROLE DE QUALIDADE E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Esterilização por irradiação, conformidade com requisitos de sistema de gestão da qualidade para dispositivos médicos (ISO 13485) e controle do processo de esterilização por radiação (ISO 11137). Realizado ensaio com embriões de camundongo (MEA) de, no mínimo, 80% de desenvolvimento até blastocisto em 96 horas e endotoxinas inferiores a 1 UI/dispositivo.

FABRICANTE

Cryo Bio System
ZI n°1 Est
61300 Saint-Ouen-sur-Iton – França
Site: www.cryobiosystem.com
E-mail: contact@cryobiosystem-imv.com